

2019 冠狀病毒病支援資訊(I)

抗疫疑問何其多？

如何掌握正確、最新的資訊？

P.1

一、快速抗原測試唔識用？

- ◇ 附件一、快速測試使用教學 (P.2)
{資料來源：同心抗疫 快速抗原測試
www.chp.gov.hk/tc/r/1347 }



二、確診後，居家隔離點算好？政府求助熱線號碼？

- ◇ 附件二、快速測試陽性 - 跟進步驟 (P.4)
{資料來源：同心抗疫 測試結果陽性跟進
www.coronavirus.gov.hk/rat/pdf/rat_flowchart_cn.pdf}
- ◇ 附件三、確診者在家隔離 (P.5)
{資料來源：同心抗疫 確診者在家隔離
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/pa_admission_isolation_CHI.pdf}

三、家人確診，緊密接觸者要點做？

- ◇ 附件四、緊密接觸者在家隔離 (P.6)
{資料來源：同心抗疫 緊密接觸者在家隔離
www.coronavirus.gov.hk/pdf/pa_early_flowchart.pdf}

附件一、快速測試使用教學

1 打開包裝


仔細參考個別品牌使用說明書。取出 (1) 採樣棒、(2) 測試溶液和 (3) 測試棒。



P.2

2 採樣棒

把採樣棒放入鼻孔內，分別沿着兩側鼻孔內壁打圈。把採樣棒前端充分浸入測試溶液，然後攪拌。

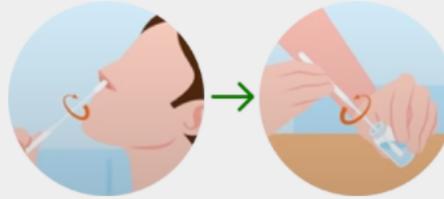

3 測試溶液

蓋好盛載測試溶液的瓶子。然後在測試棒的樣品孔內，慢慢滴入測試溶液。



4 測試棒

按使用說明書指示的等候時間讀取結果。超過指定時間，結果無效。



5 妥善棄置

進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。



附件一、快速測試使用教學

注意個人衛生

- ◇ 測試前後，請清潔雙手。
- ◇ 採集呼吸道樣本時，找一個乾淨、通風的地方，四周盡量減少放置非必要的用品。
- ◇ 應與他人保持最少 2 米距離。
- ◇ 環境如受污染，應以 1 比 49 稀釋家用漂白水進行環境清潔工作。
- ◇ 至於金屬表面，則需要以 70%酒精消毒。

記錄測試結果

- ◇ 進行「居安抗疫」人士，必須在讀取測試結果後立即拍照，以保留所有檢測結果，並按照檢疫手冊指示作出記錄。

不成功測試注意事項

- ◇ 「採樣」，採樣棒伸進鼻，不夠深入。
- ◇ 「樣本混入溶液」，採樣棒攪動溶液次數不足。
- ◇ 「滴入溶液」，滴入橢圓形開口，每一滴完全吸收後，才能繼續滴。

快速測試使用教學


{資料來源：同心抗疫 快速抗原測試 www.chp.gov.hk/tc/r/1347}



快速測試注意事項

資料來源：同心抗疫 快速抗原測試 {<https://www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html>}

附件二、附件 快速測試陽性 – 跟進步驟

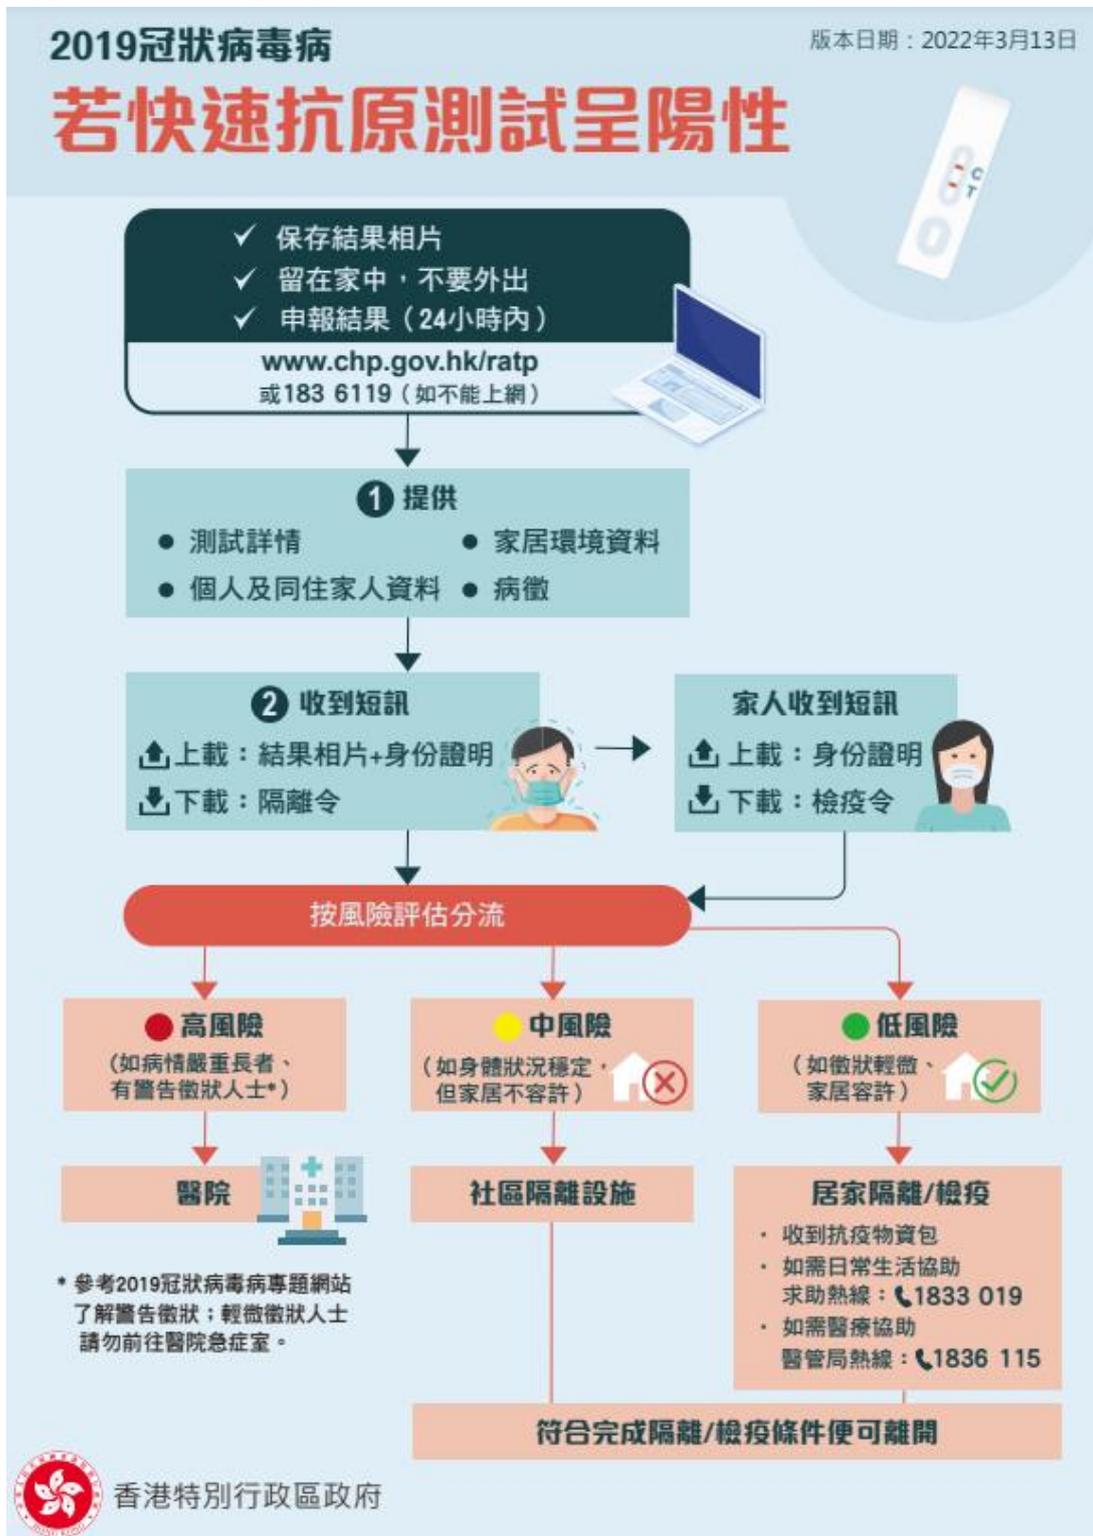


附件三、確診者在家隔離



{資料來源: 同心抗疫 - 尚待入院人士須知 www.coronavirus.gov.hk/pdf/pa_admission_isolation_CHI.pdf }

附件四、緊密接觸者在家隔離

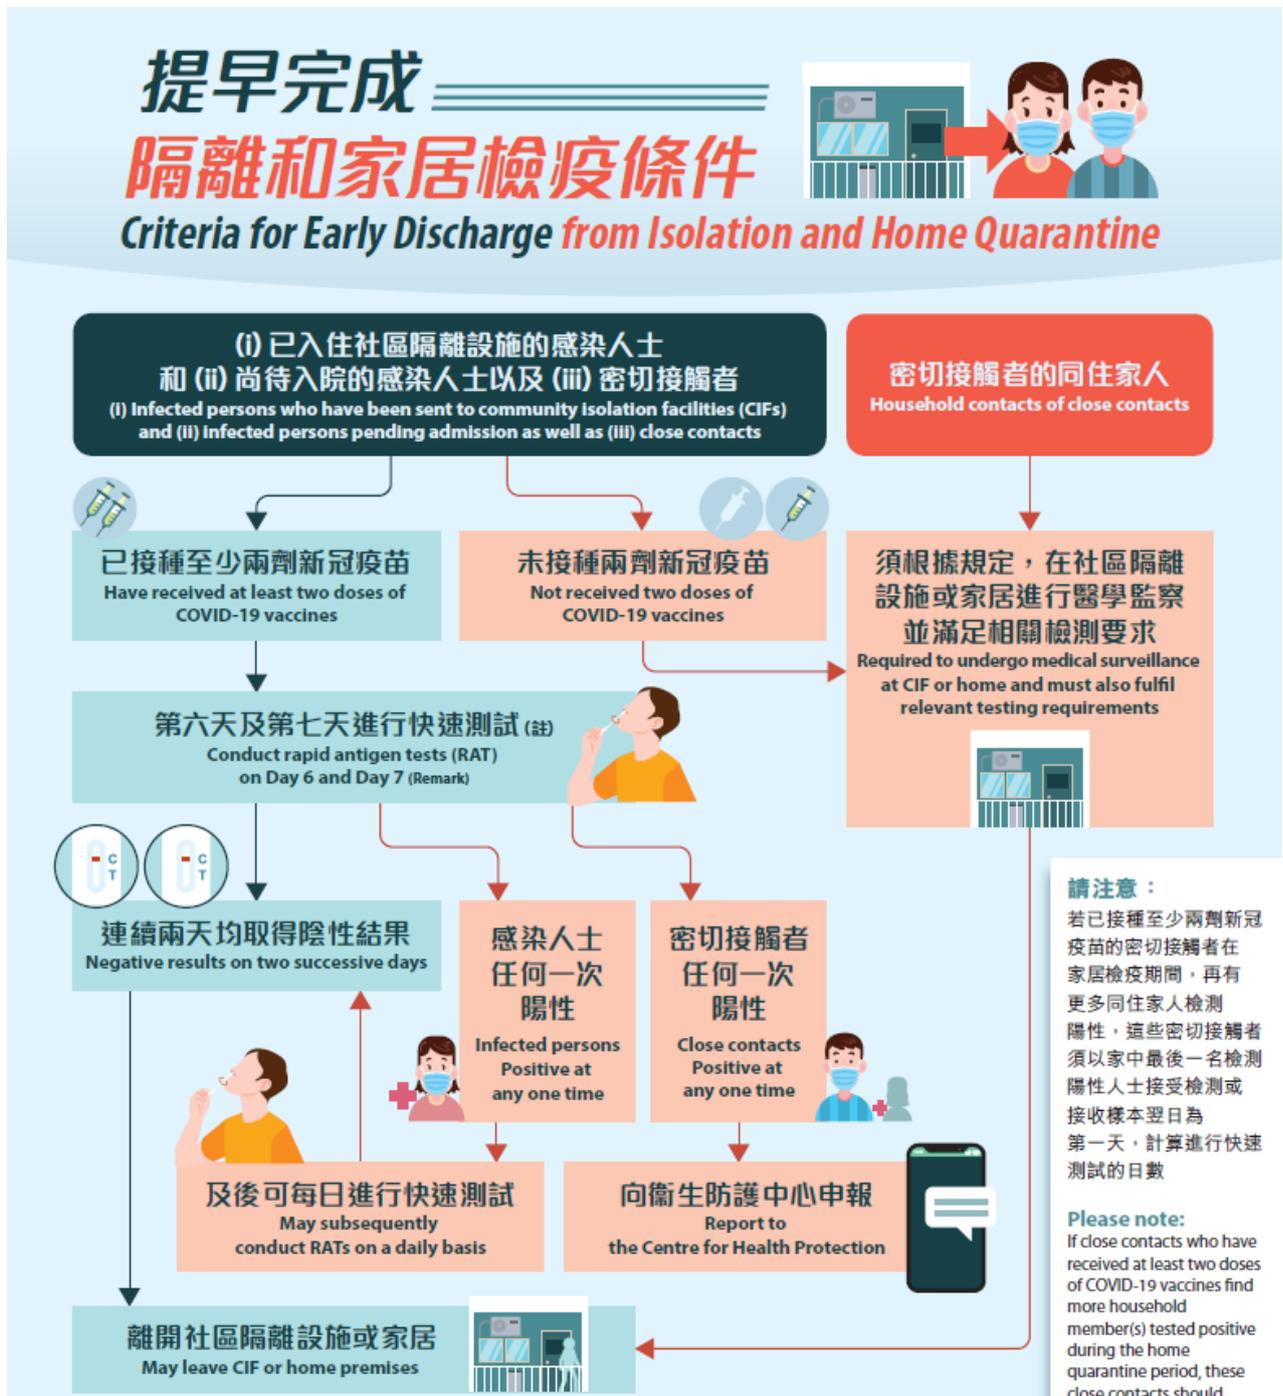

附件三、次密切接觸者在家隔離

- ◇ 次密切接觸者，如同住家人
- ◇ 須接受四天家居檢疫。(根據法例，你須留在家居直至檢疫期完結，並須遵從相關要求，如你未遵從相關要求，可被 罰款及監禁。)
- ◇ 須進行快速抗原檢測 (第一天, 第二天及第四天)

1 健康監測及檢測安排

- 你需每天量度體溫兩次及留意自己的身體狀況。
- 如你發燒38度或以上或有其他較嚴重的徵狀包括氣促，心悸及心胸痛，你有可能染上新型冠狀病毒病，請即時致電「居安抗疫計劃」熱線報告身體狀況，經評估後安排送院處理。
- 如遇上緊急情況，請致電999。
- 如果你檢疫期是4天，以今日是第一天計，你必須在檢疫期第一天，第二天及第四天自行進行快速抗原檢測。
- 請細閱「2019 冠狀病毒病快速抗原測試注意事項」，有關使用方法可以瀏覽 <https://www.chp.gov.hk/tc/r/1347> 或掃描以下二維碼。



陰性



陽性

- 如快速抗原檢測結果是陽性，你很有可能染上新型冠狀病毒病，請即時致電「居安抗疫計劃」熱線報告。你可能會被安排送院治療。
- 如快速抗原檢測結果為無效，請查看樣本類別、樣本採集過程和進行測試的方法是否按製造商的指示，並按指示重新使用新的測試套件進行測試。如你需要索取額外抗原檢測套裝，請致電「居安抗疫計劃」熱線。
- 請在讀取測試結果後**立即拍照**以保留所有檢測結果。

{資料來源: 同心抗疫 - 家居檢疫人士

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Close_Contact_of_Close_Contact_tc.pdf }